

Krokmetre Serisi

Kuru ve yaş sürtmede renk transferinin değerlendirilmesi

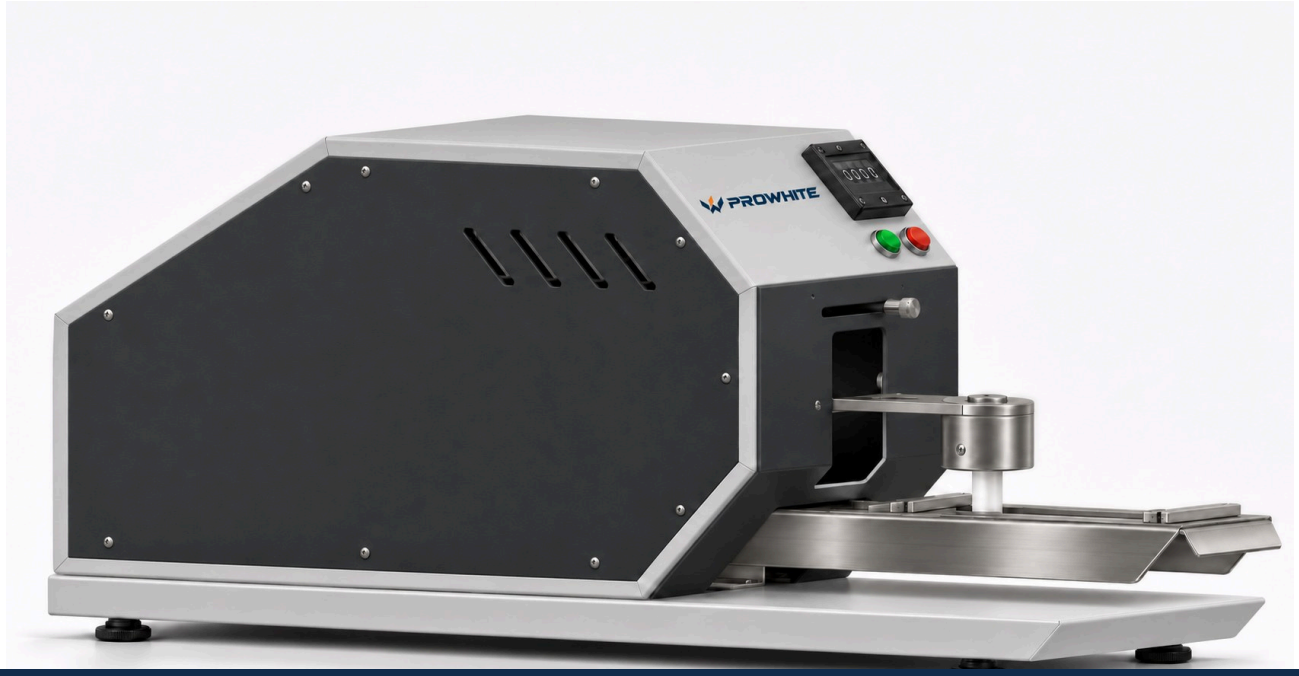

OTOMATİK / PW-K013-A

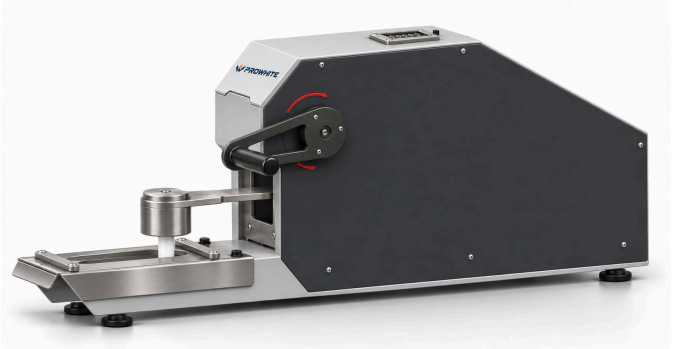

MANUEL / PW-K013-M



DAİRESEL / PW-K013-R

Üç model. Doğru yönteme uygun seçim.


Tekstil kalite kontrolü • Boyahane • Baskı • Ar-Ge

Aynı amaç, farklı test hareketleri

Numunedeki rengin standart beyaz pamuklu sürtme bezine geçişi değerlendirilir. Kuru ve yaş testler ayrı yürütülür; bezdeki lekelenme uygun gri skala ile karşılaştırılır.



Numune çeşitliliği

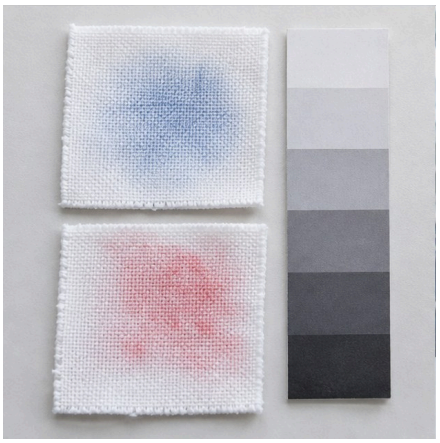

Renk transferi değerlendirmesi



Kalite kontrol laboratuvarı


Özellik	Otomatik	Manuel	Dairesel
Model	PW-K013-A	PW-K013-M	PW-K013-R
Test hareketi	Doğrusal	Doğrusal	Dönüşümlü dairesel
Tahrik	Motorlu	El kolu	El kolu
İzleme	Elektronik sayaç	Mekanik sayaç	Sayaç
Öne çıkan kullanım	Rutin seri testler	Elle kontrollü testler	Küçük baskılı alanlar
Ana yöntemler	ISO 105-X12 AATCC TM8	ISO 105-X12 AATCC TM8	ISO 105-X16 AATCC TM116

Seçim notu

Dairesel model, küçük renkli bölgelerin seçilmesine olanak tanır. Doğrusal ve dairesel yöntem sonuçları birbirinin yerine kullanılmaz; seçim ilgili ürün şartnamesine göre yapılır.

Otomatik Krokmetre

Motorlu doğrusal sürtme • Elektronik sayaç

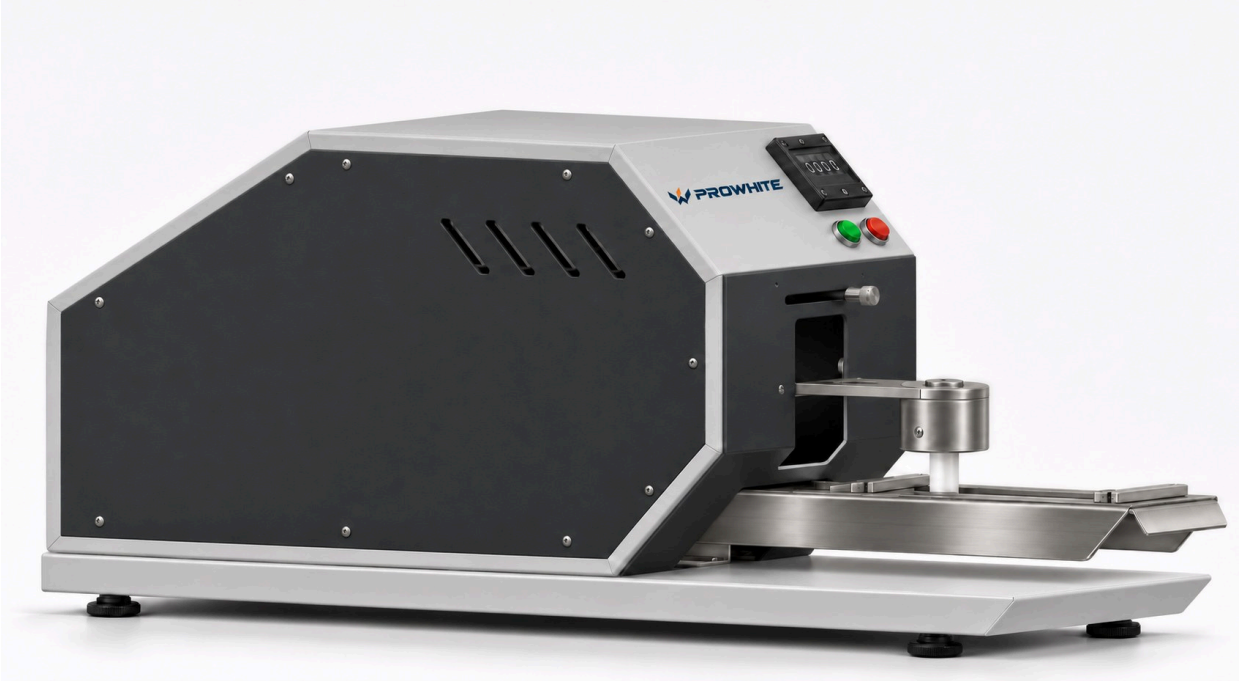

Rutin kuru ve yaş sürtme testlerinde motorlu hareket, test çevrimini operatörün elle çevirme hızından bağımsız yürütür. Numune, test tablası üzerindeki tutucularla sabitlenir.

KULLANIM AVANTAJLARI

• Elektronik sayaçla çevrim takibi

• Yeşil / kırmızı kumanda butonları

• Erişilebilir numune bağlama alanı

• Metal gövde ve sürtme mekanizması


Test koşulu	Kuru / yaş
Sürtme ucu	Ø16 mm
Doğrusal strok	104 mm
Baskı kuvveti	9 N
Değerlendirme	Lekelenme gri skalası
Tahrik	Elektrik motorlu

İLGİLİ TEST STANDARTLARI

ISO 105-X12 • AATCC TM8
ISO 105-A03 (lekelenme değerlendirmesi)

Manuel Krokmetre

El kolu ile doğrusal sürtme • Mekanik sayaç

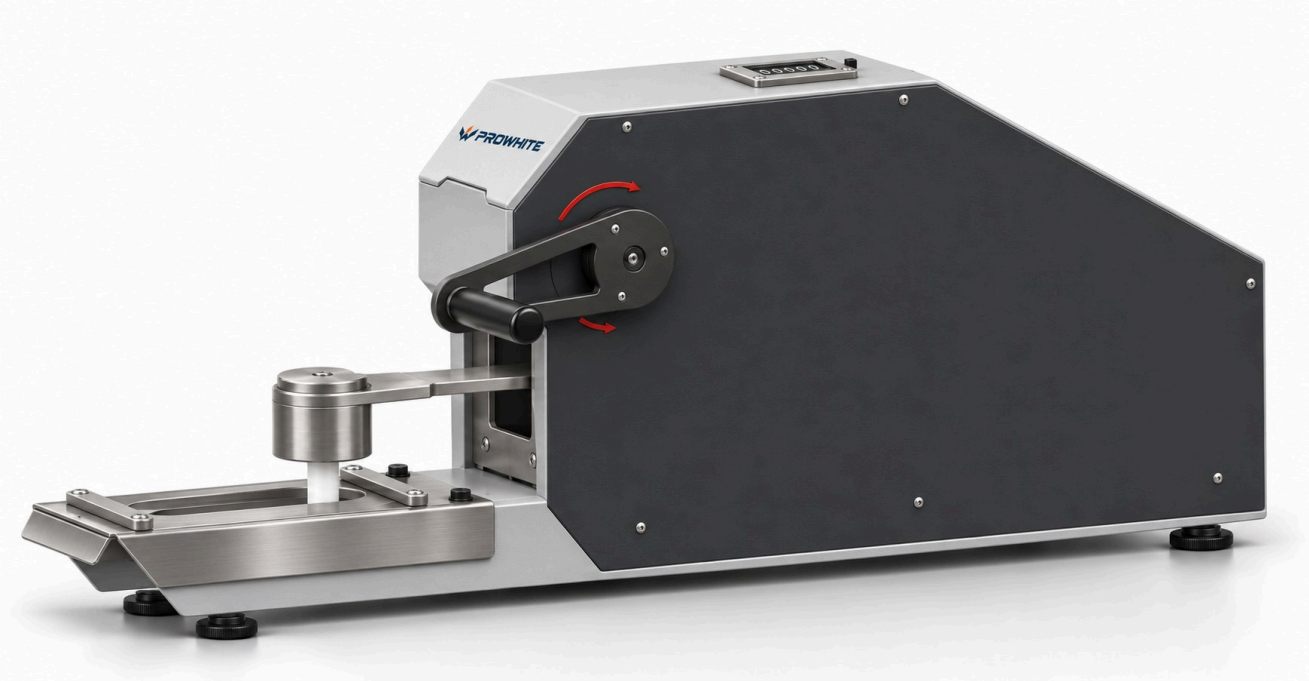

El kolu, sürtme ucunu numune üzerinde ileri ve geri hareket ettirir. Üstteki mekanik sayaç çevrimlerin izlenmesini sağlar. Kuru ve yaş sürtme değerlendirmelerinde basit bir çalışma düzeni sunar.

KULLANIM AVANTAJLARI

- El koluyla doğrudan test kontrolü
- Üstten okunabilen mekanik sayaç
- Kuru ve yaş testlere uygun düzenek
- Numuneye erişimi kolay açık test alanı

Test koşulu	Kuru / yaş
Sürtme ucu	Ø16 mm
Doğrusal strok	104 mm
Baskı kuvveti	9 N
Değerlendirme	Lekelenme gri skalası
Tahrik	Manuel el kolu

İLGİLİ TEST STANDARTLARI

ISO 105-X12 • AATCC TM8
ISO 105-A03 (lekelenme değerlendirmesi)

Dairesel Krokmetre

Küçük alanlarda renk haslığı değerlendirmesi



Özellikle baskılı ve çok renkli tekstillerde küçük bölgelerin ayrı değerlendirilmesi için kullanılır. Düşey sürtme ucu, numune üzerinde saat yönünde ve ters yönde dönüşümlü hareket eder.

KULLANIM AVANTAJLARI

- Küçük desen ve renk alanlarına erişim
- Üst ağırlıkla düşey yük uygulaması
- El kolu ve sayaçla kullanım
- Kompakt, açık numune alanı

Test koşulu	Kuru / yaş
Sürtme ucu	Ø16 mm
Uygulanan yük	1134 g
Dönüş hareketi	1,125 tur; iki yönde
Tahrik	Manuel
Değerlendirme	Lekelenme gri skalası

İLGİLİ TEST STANDARTLARI

ISO 105-X16 • AATCC TM116
ISO 105-A03 (lekelenme değerlendirmesi)

Testi tamamlayan donanım

Temel cihaz donanımı

Seçilen modelin sürtme mekanizması, sayacı, numune tutma düzeni ve yük uygulama parçaları. Model seçimi sipariş kapsamına işlenir.

Ek sarf ve değerlendirme araçları

Standart pamuklu sürtme bezleri; lekelenme gri skalası; numune sabitleme yüzeyleri; yedek sürtme ucu ve tutucu parçalar. İhtiyaç duyulan kalemler ayrıca belirtilir.



Tutarlı değerlendirme için

Bez kondisyonlama, yaş testte su alma oranı, numune yönü ve çevrim sayısı seçilen yönteme göre uygulanır. Lekelenme, uygun aydınlatmada değerlendirilir. Test kaydında model, yöntem, kuru/yaş koşul ve sonuç birlikte tutulur.

Laboratuvarınız için doğru modeli seçelim.

PROWHITE Teknoloji A.Ş.

prowhite.com.tr

info@prowhite.com.tr

+90 212 671 05 03

WhatsApp ile bilgi isteyin

Gökevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 563. Sokak,
No: 9-A, Esenyurt / İstanbul, Türkiye

Her Aşamada Hassasiyet. Her Testte Güven.